

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę obłóżek, znak PN/21/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłóżek, znak PN/21/2020


Do Zamawiającego w dniu 06.07.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Dot. Pakietu VI: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². (niepiaksowana)
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

serwety: PP/PE 62gsm (PP 27 g/m². + klej 5 g/m². + PE 30 g/m².) + wzmocnienie: spunlace 70 g/m².
Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H₂O. Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA.
Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym. Zestaw w kolorze niebieskim.

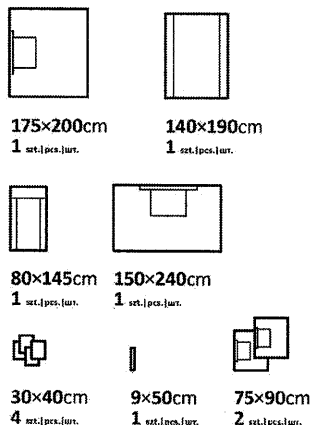


2. Dot. Pakietu IX: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 7x60cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 100x130cm

- 1 serweta przylepna (ekran anestetyczny) 150x240cm, wzmocnienie o wymiarach 50x75cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG.

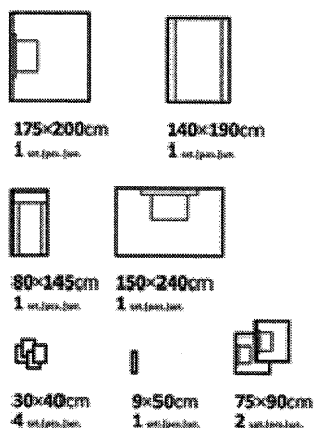


3. Dot. Pakietu X: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przyklepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem.
- 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 1 ręcznik celulozowy 30x40cm

serwety: PP/PE 62gsm (PP 27 g/m². + klej 5 g/m². + PE 30 g/m².)


Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG.

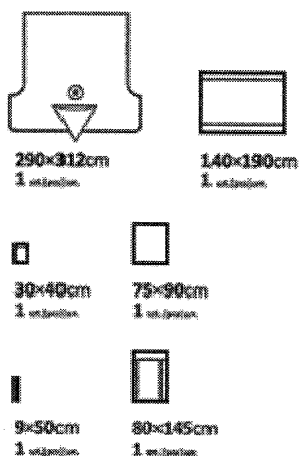

4.Dot. Pakietu XI: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240 x 354 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 24 x 20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną wokół otworu o wymiarach 80x100 cm oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów
- 4 serwety samoprzylepne 45 x 45 cm
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm
- 1 taśma typu „rzep” 2,5 x 25 cm
- 1 samoprzylepna kieszeń jednokomorowa ze sztywnikiem 30 x 40 cm
- 1 samoprzylepna kieszeń dwukomorowa ze sztywnikiem 30 x 40 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

serwety: PP/PE 62gsm (PP 27 g/m². + klej 5 g/m². + PE 30 g/m².) + wzmocnienie: spunlace 70 g/m². Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG.

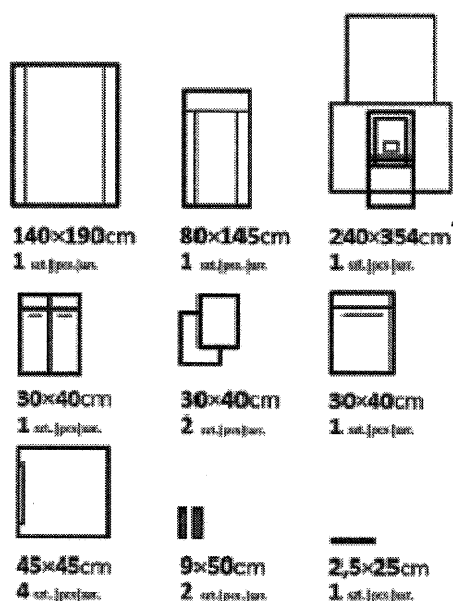

5. Dot. Pakietu XIII poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie fartuchów o parametrach jak poniżej:

Uniwersalny fartuch jałowy, pełnobarierowy rozmiar L (długość 130 cm), posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, szwy czterościeżkowe ultradźwiękowe. Gramatura min. 35 g/m², szerokie rękawy typu reglan zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy. Odporność na przenikanie cieczy 49.5 H₂O, Odporność na rozerwanie na sucho 140 Kpa, na mokro 130Kpa, Wykonany z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowy; na opakowaniu 2 samoprzylepne etykiety. Pakowany z dwoma ręczniczkami do osuszania rąk.

6. Dot. Pakietu XIII poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie fartuchów o parametrach jak poniżej:

Uniwersalny fartuch jałowy, pełnobarierowy rozmiar XL (długość 140 cm), posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, szwy czterościeżkowe ultradźwiękowe. Gramatura min. 35 g/m², szerokie rękawy typu reglan zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy. Odporność na przenikanie cieczy 49.5 H₂O, Odporność na rozerwanie na sucho 140 Kpa, na mokro 130Kpa, Wykonany z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowy; na opakowaniu 2 samoprzylepne etykiety. Pakowany z dwoma ręczniczkami do osuszania rąk.

7. Dot. Pakietu XIII poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie fartuchów o parametrach jak poniżej:

Wzmocniony fartuch do mokrych operacji jałowy, pełnobarierowy rozmiar XL (długość 140 cm.) posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, szwy czterościeżkowe ultradźwiękowe, o gramaturze min. 35 g/m², szerokie rękawy typu reglan zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na ¾ rękawów o gramaturze 40 g/m², odporność na przenikanie cieczy 215cm H₂O w strefie krytycznej, odporność na rozerwanie na sucho 150 Kpa w strefie krytycznej, na mokro 140 Kpa w strefie

krytycznej, wykonany z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowy; na opakowaniu 2 samoprzylepne etykiety. Pakowany z dwoma ręczniczkami do osuszania rąk.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.07.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 06.07.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos